


SIRIUS

CNPJ: 21.236.888/0001-36
INSC. EST.: 003196341.00-92

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA - MA
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

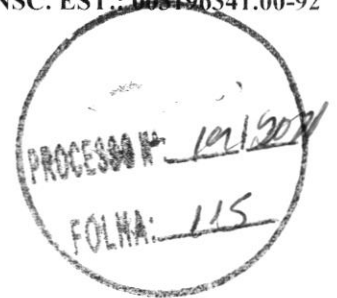

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social:	SIRIUS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ME
CNPJ Nº	21.236.888/0001-36
INS Est:	003196341.00-92
Endereço:	Rua Felipe Camarão, nº 154
Bairro:	Esplanada
Cidade / Estado:	Belo Horizonte / Minas Gerais
CEP:	30.280-260
Tel/FAX:	31 3465.9422
Pessoa para contato:	Cristiane Reis
Email:	licitacao@siriustecnologia.com
Dados Bancários:	SICOOB CREDICOM BANCO. 756 AG. 4027 C/C 28.915.902-4

ITEM	QT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	500	<p><u>BASALL TESTE 2019-nCov Antígeno</u></p> <p>Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Reg. MS nº 80520090048</p> <p>O Basall Teste 2019-nCoV Antígeno (Método de Fluxo Lateral) é um ensaio imunocroma tográfico para detecção rápida e qualitativa do antígeno coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) extraído do esfregaço nasofaríngeo ou amostra de esfregaço orofaríngeo.</p> <p>Quando a amostra extraída é adicionada ao dispositivo de teste, a amostra é absorvida pelo</p>	R\$46,00	R\$23.000,00

SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME
RUA FELIPE CAMARÃO, 154 –ESPLANADA –BELO HORIZONTE/ MG
FONE: +55 31 3465-9422– EMAIL – licitacao@siriustecnologia.com

SIRIUS

CNPJ: 21.236.888/0001-36
INSC. EST.: 003196341.00-92

dispositivo por ação capilar, mistura-se com o conjugado anticorpo-corante SARS-CoV-2 e flui através da membrana pré-revestida

O tubo de extração da amostra, o conta gotas e o dispositivo teste devem ser descartados após o uso. Proibido Reutilizar. Evite temperaturas excessivamente altas no ambiente do experimento. Teste os cartões e o buffer de detecção armazenados em baixa temperatura precisam retornar à temperatura ambiente antes de serem abertos para evitar a absorção de umidade. Não toque na área de reação da tira de teste. Não use o kit de teste após a data de validade. Não use o kit se a embalagem estiver furada ou mal vedada. O teste deve ser aplicado por profissional qualificado. O resultado do teste deve ser interpretado pelo médico juntamente com os achados clínicos e outros resultados de testes laboratoriais. **DESCARTE DO DIAGNÓSTICO:** Todas as amostras e o kit usado apresentam risco de infecção. O processo de descarte do kit teste deve seguir a lei local de descarte de infecções ou os regulamentos do laboratório.

Fabricante: LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda

Distribuído por: LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda



gust *X*

SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME
RUA FELIPE CAMARÃO, 154 –ESPLANADA –BELO HORIZONTE/ MG
FONE: +55 31 3465-9422– EMAIL – licitacao@siriustecnologia.com






CNPJ: 21.236.888/0001-36
INSC. EST.: 003196341.00-92

ITEM	QT	ESPECIFICAÇÕES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	3.000	<p><u>Kit de Teste Covid-19 Basall</u></p> <p>NCM: 3002.15.90 Marca : Basall Validade 17 meses após a data de fabricação Origem: Brasil Reg. MS n° 80520090045 Fabricante: LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda Distribuído por: LMG Lasers Comércio, Importação e Exportação Ltda</p>	R\$16,80	R\$50.400,00

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Kit de Teste Covid-19 Basall

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Este teste foi desenvolvido para a detecção qualitativa de anticorpos COVID-19 IgM/IgG em amostras de soro humano, plasma ou sangue venoso, como diagnóstico auxiliar da infecção por COVID-19.

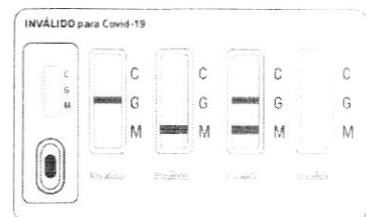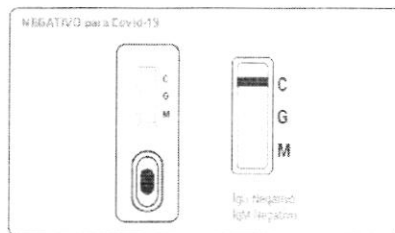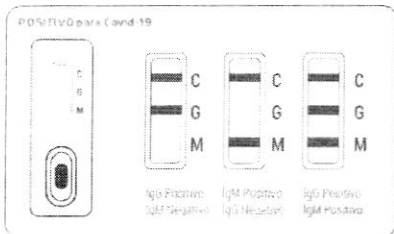

SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME
RUA FELIPE CAMARÃO, 154 –ESPLANADA –BELO HORIZONTE/ MG
FONE: +55 31 3465-9422– EMAIL – licitacao@siriustecnologia.com

SIRIUS



CNPJ: 21.236.888/0001-36
INSC. EST.: 003196341.00-92

IgM - Sensibilidade: $23/24 = 0,9583 * 100 = 95,83\%$ - Especificidade: $76/76 = 1 * 100 = 100\%$
IgG - Sensibilidade: $11/12 = 0,91667 * 100 = 91,67\%$ Especificidade: $88/88 = 1 * 100 = 100\%$


COMPOSIÇÃO: 100 unidades do dispositivo teste
04 unidades do frasco com reagente
100 unidades de pipeta
100 unidades de lanceta
01 manual de instrução de uso

FINALIDADE DE USO: COVID-19 IgG/IgM é um teste imunocromatográfico para a detecção qualitativa de anticorpos IgG/IgM contra a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2 (SARS-CoV-2) em amostras de soro, plasma e sangue total humano.

TIPO DE MOLECULA IDENTIFICADA: Anticorpos

IMAGENS DO PRODUTO:

Embalagem contendo um teste rápido

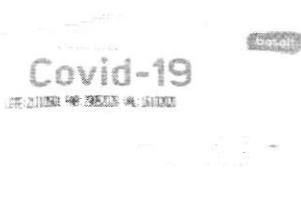

Teste



Lanceta



Pipeta



Reagente



ACURÁCIA

Dias IgG IgM

0 dias 0% para IgG e 0% para IgM

~7 dias 28,57% (2/7) para IgG 42,86% (3/7) para IgM

~14 dias 31,25/5 (5/16) para IgG 81,25% (13/16) para IgM

~21 dias 93,33% (14/15) para IgG 60,00% (9/15) para IgM

~28 dias 100,00% (2/2) para IgG 50,00% (12/12) para IgM


~30 dias 100% (9/9) para IgG 33,33% (3/9) para IgM

Como chegou

ACURÁCIA NO D7 APÓS SINTOMAS

SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME
RUA FELIPE CAMARÃO, 154 –ESPLANADA –BELO HORIZONTE/ MG
FONE: +55 31 3465-9422– EMAIL – licitacao@siriustecnologia.com

Significance of IgM & IgG

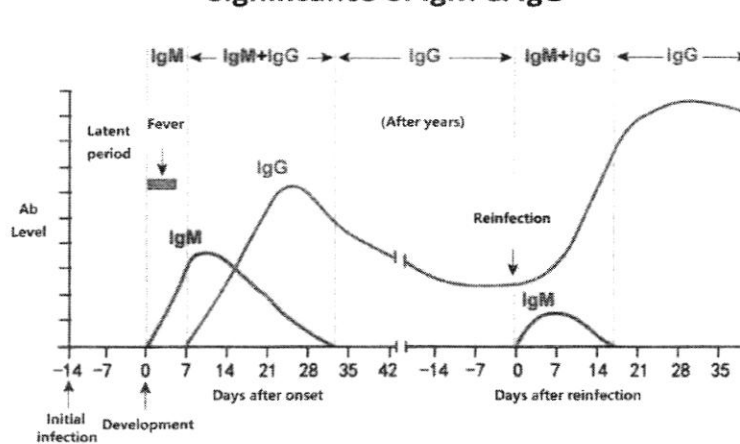

Como chegou ao resultado do teste (apenas in vitro ou fase 3, por exemplo)

Foram realizados testes in vitro com amostras de soro reagente e não reagente (comparando com metodologias, por exemplo, PCR)

Público a operar o Kit

A manipulação deve ser feita apenas por *profissional de saúde*.

Condições de armazenamento e Transporte


1. Armazene em temperatura entre 2°C e 30°C em local fresco, sem luz solar direta. O teste deve ser executado em no máximo 30 minutos após a abertura da embalagem (temperatura de abertura 10°C ~ 30°C, umidade 25% ~ 95%).
2. O kit deve permanecer na embalagem lacrada até o momento do uso. Não congelar, não armazenar em temperaturas superiores a 30°C. O kit deve permanecer o tempo todo protegido de qualquer tipo de contaminação. Não utilizar se houverem sinais de ruptura do lacre. Qualquer tipo de contaminação pode levar a resultados falsos.
3. A data de produção, lote e validade estão rotulados na embalagem. Nunca utilize o kit fora do período de validade.

4. Válido por 17 meses.

EMBALAGEM: Caixa de papel cartão contendo 100 unidades do dispositivo teste embalados individualmente em envelope laminado, 100 unidades de pipetas descartáveis, 100 unidades de lancetas e 4 unidades do frasco com reagente. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº36/2015, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

Caixa com 100 unidades do dispositivo teste, 100 unidades de pipetas descartáveis, 4 unidades do frasco com reagente, 100 unidades de lancetas

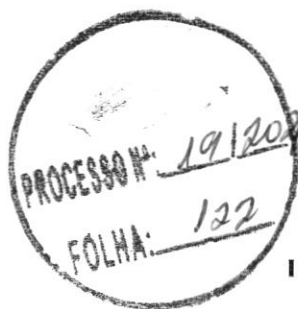

CNPJ: 21.236.888/0001-36
INSC. EST.: 003196341.00-92

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Declaramos que nos preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, encargos sociais, seguros, fretes, serviços de montagem dos equipamentos e outros;

VALIDADE DA PROPOSTA: validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação.

VALIDADE DO CONTRATO: O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço é de **06 (seis) meses** conforme previsão no termo de referência.

PRAZO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer no local de entrega mencionado, no prazo de até 05 dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra;

LOCAL DE ENTREGA: Endereço mencionado na autorização de fornecimento;

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: agosto de 2022.

PRAZO DE PAGAMENTO: Em até 30 dias consecutivos, a contar da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente.

Dados do responsável pela empresa para assinatura do contrato de fornecimento:

Indicamos o Sr. Cleverson de Castro Barbosa, Diretor, CI: M3.416.663 - SSP-MG e CPF: 012.997.966-05;

Belo Horizonte, 09 de junho de 2021

Cleverson de Castro Barbosa

CI: RG nº M- 3.416.663

CPF: 012.997.966-05

Proprietário

SIRIUS Equipamentos Médicos Hosp. EIRELI

SIRIUS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ME
RUA FELIPE CAMARÃO, 154 –ESPLANADA –BELO HORIZONTE/ MG
FONE: +55 31 3465-9422– EMAIL – licitacao@siriustecnologia.com